

微型光纤光谱仪

[S3000-VIS-HR]



S3000-VIS 是一款 Czerny-Turner 结构的微型光谱仪，该光谱仪广泛应用于多种行业及领域。
该产品还配备了我司自主研发的软件和软件开发包，便于用户使用及二次开发。

» 特性

- 波长范围: #A (400nm ~ 700nm) #B (500nm ~ 800nm) #C (600nm ~ 900nm) #D (700nm ~ 1000nm)
- 软件开发包支持 Windows / Embedded system / Linux / Android 系统
- 支持 RS232 串口通信协议
- 光学分辨率 (FWHM) 最小值 0.2nm

» 应用

- 激光光谱分析

» 产品参数

项目	值	单位
尺寸	115 mm(L) x 80 mm (W) x 40 mm (H)	mm
重量	500g	g
光纤接口	SMA905	-
狭缝	10um (默认) 5/10/20/25/30/50/100/150/200um (可选)	um
光栅	1200@500nm	线对数/mm
探测器 (CCD)	Toshiba TCD1304DG	-
像素总数	3648	像素
A/D 分辨率	16 bit	-
USB 接口	USB2.0	-
通讯接口	USB RS232 / LAN (可另加配)	-
软件	Spectra + SpectraPro	-
软件开发包 (SDK)	支持 Windows / Embedded System / Linux / Android	-


» 电源&温度 额定参数

项目	最小值	典型值	最大值	单位
供电电源 (USB Bus Power)	4.5V	5V	+6.0V	V
外部电源 (Optional)	4.5V	5V	+6.0V	V
环境温度	-10°C	25°C	60°C	°C
存储温度	-20°C	25°C	70°C	°C

» 光电特性 (推荐温度 25°C)

项目	最小值	典型值	最大值	单位
功耗	-	160mA@5V	170mA@5V	mA
波长范围	400nm ~ 700nm	500nm ~ 800nm	700nm ~ 1000nm	nm
波长精度	±0.20	±0.40nm	±0.80	nm
波长重复性	±0.12	±0.15nm	±0.20	nm
波长分辨率 (相邻像素波长值之差)	0.12	0.15nm	0.20	nm
光学分辨率 (FWHM)	0.20	0.3nm	0.50	nm
波长热稳定性	-	0.05	-	nm/°C
杂散光	0.05	0.20%	0.40	%
修正线性度	99.0	99.8%	-	-
数值孔径	-	0.22	-	-
信噪比 (SNR)	-	500:1	-	-
最小积分时间	-	0.1ms	-	ms

» 外形尺寸图 (单位:mm)

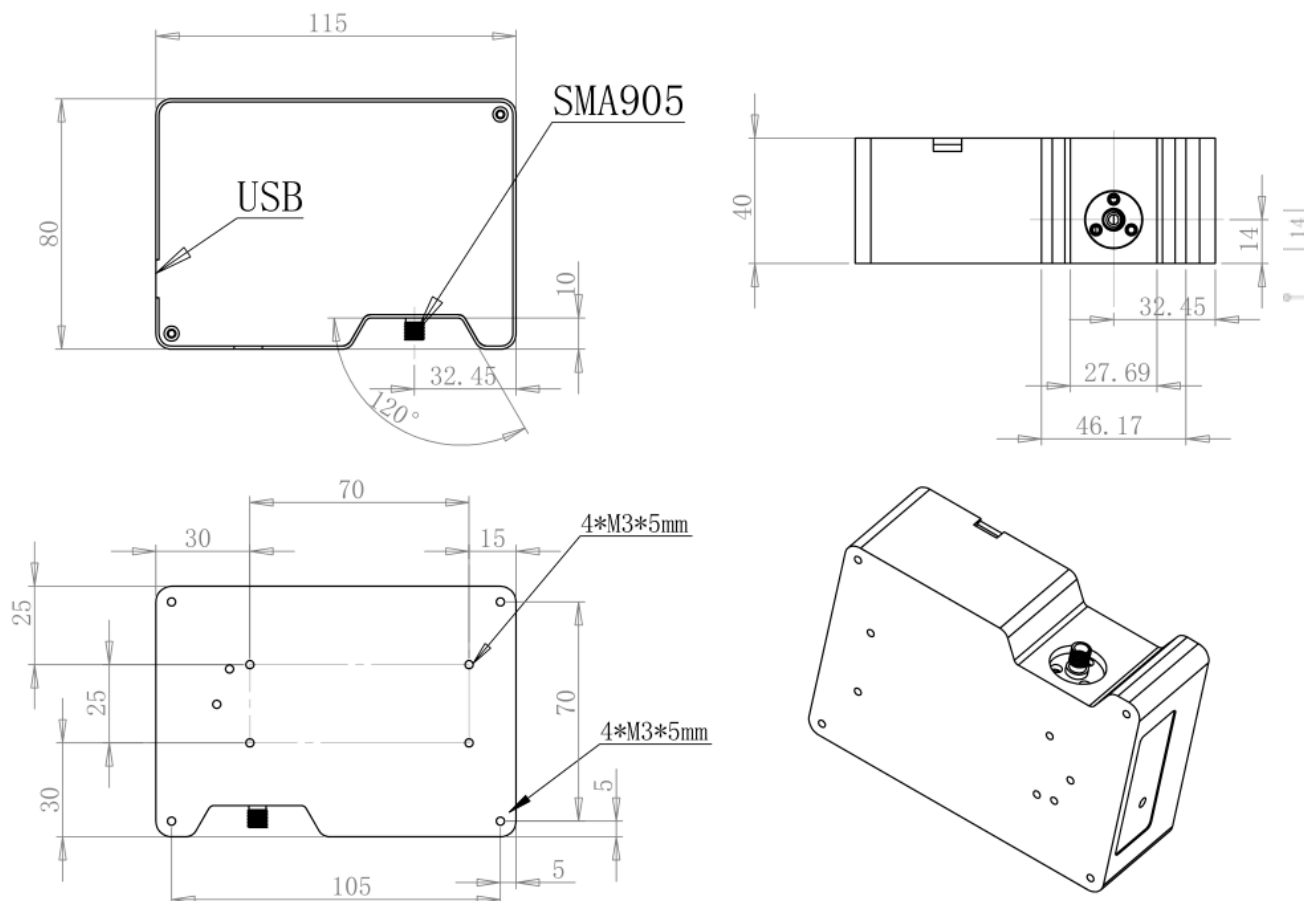

7

杭州赛曼科技有限公司

©地址: 浙江省 杭州市 滨江区 东冠路611号金盛科技园3号楼5楼

©电话: 188 5788 5722 ©邮箱: sales@seemantech.com

©网址: www.seemantech.com